

# 個装箱仕様変更等のご案内

経口用セフェム系製剤  
**日本薬局方 セフィキシムカプセル**  
**セフspan®カプセル50mg**  
**セフspan®カプセル100mg**

2018年2月

お得意様各位

日本ジェネリック株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび『セフspanカプセル50mg』及び『セフspanカプセル100mg』につきまして、個装箱の仕様変更等をさせていただきますので下記の通りご案内致します。

この変更に際しまして大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも引き続き弊社製品に御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

## 変更内容


※下記の個装箱は全てイメージです

### 個装箱の仕様変更等

(1) 開封口の変更: 次の通りデザインを変更の上、開封口の位置と形状を変更致します。



(2) 解体用ミシン目の追加

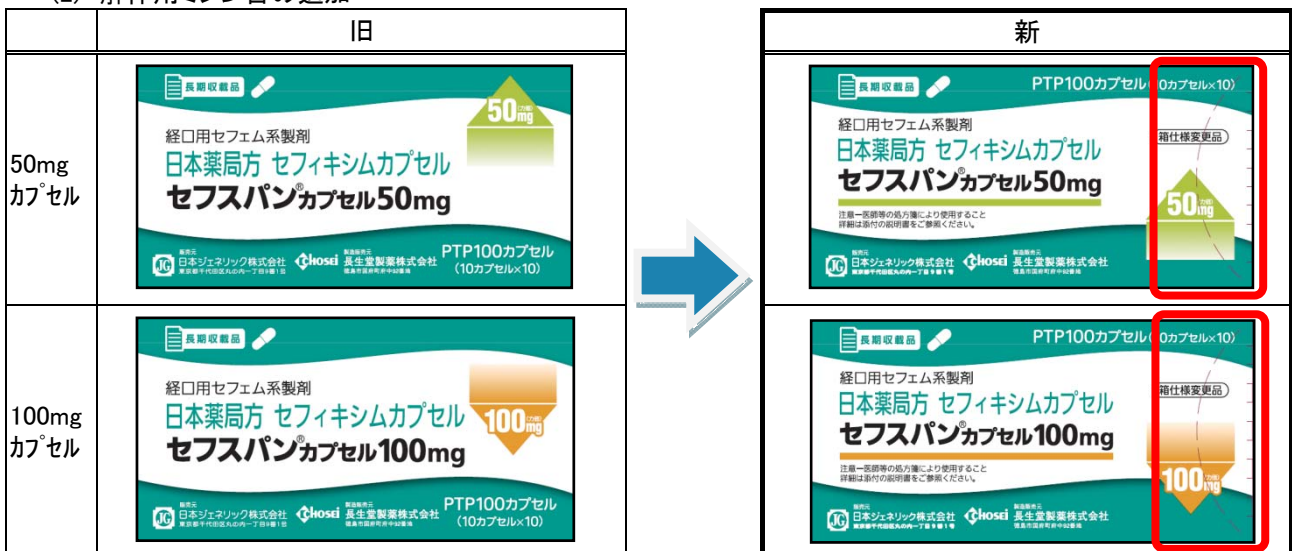

(裏面へ続く)

- (3) 可変情報対応:『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』(平成 24 年 6 月 29 日付医政経発 0629 第 1 号・薬食安発 0629 第 1 号)の通知に基づき、販売包装単位コードを使用期限及び製造番号の情報を追加した可変情報対応のバーコードに変更致します。

#### 変更品の出荷時期と初回製造番号

製品名	包装単位	出荷予定時期	初回製造番号	使用期限
セフспанカプセル50mg	PTP100カプセル	2018年3月頃	CJ031	2019年9月
セフспанカプセル100mg	PTP100カプセル	未定	CJ031	2019年9月

製品の流通状況により、変更品のお届けまでに多少の時間を要する場合がありますので、ご了承頂きますようお願い致します。  
※セフспан細粒50mgにつきましても、類似の変更予定がございますので、出荷予定時期に合わせてご案内致します。

#### 変更品の個装箱表示

個装箱に **箱仕様変更品** の表示を致します。

#### お問い合わせ先

お客さま相談室:0120-893-170

受付時間:月～金9:00～18:00(祝日を除く)

以上

包装変更などのお知らせ文書は、弊社の医療関係者向けホームページにも掲載しております。

<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>

