

ポンプ仕様変更等のご案内

血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%[YD]

2016年3月

お得意様各位

日本ジェネリック株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび『ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%[YD]』につきまして、ポンプの仕様変更等をさせていただきますので下記の通りご案内致します。

この変更に際しまして大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも引き続き弊社製品に御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

記

変更内容

① ポンプの仕様変更

次の通り視認性の向上の為、ポンプの噴霧口色を白からピンクに変更します。また、押し込みの力低減の為、内部のパネの力を弱くする変更をします。

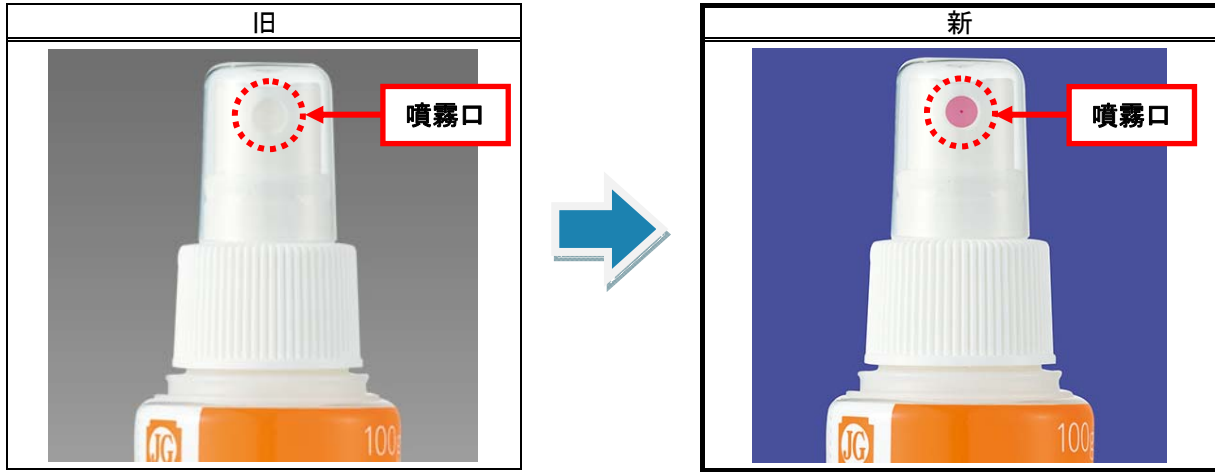

※写真の色調が現物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。

② 個装箱の JAN コード削除

『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』(平成 24 年 6 月 29 日付医政経発 0629 第 1 号・薬食安発 0629 第 1 号)の通知に基づき、個装箱に表示されている JAN コードを削除致します。

変更品の出荷時期と初回製造番号

製品名	包装単位	出荷開始日	初回製造番号	使用期限
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%[YD]	100g×10本	2016年5月2日	YKA-1	2018年12月

製品の流通状況により、変更品のお届けまでに多少の時間を要する場合がありますので、ご了承頂きますようお願い致します。

変更品の個装箱表示

個装箱に、**ポンプ仕様変更品** の表示を致します。

お問い合わせ先

お客さま相談室:0120-893-170

受付時間:月～金9:00～18:00(祝日を除く)

以上

包装変更などのお知らせ文書は、弊社の医療関係者向けホームページにも掲載しております。

<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>