

ボトル形状変更及び個装箱仕様変更等のご案内

日本薬局方 生理食塩液 生食液 NS

2018年7月

お得意様各位

日本ジェネリック株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび『生食液NSルーアーフットポリエチレンボトル(20mL)』につきまして、ボトルの形状変更及び個装箱の仕様変更等をさせていただきますので下記の通りご案内致します。

今後とも引き続き弊社製品に御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

※下記のラベル及び個装箱は全てイメージです

変更内容

※写真及び画像の色調が現物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。

- ① ボトル形状・サイズ変更等: 次の通り、ルーアーフットポリエチレンボトルをツイストルーアーフットポリエチレンボトルに変更し、GS1コード(調剤包装単位)を変更致します。
視認性向上のために、ラベルのフォントをユニバーサルデザイン(UD)フォントに変更致します(社名・マーク類を除く)。(通常の文字に比べ、文字間隔を広げる、濁点と半濁点を大きくする等、文字を見やすくするための配慮をしました。)



※ルーアーフットポリエチレンボトルはボトルを押しして内用液を押し出すようなデザインとしています。



※改良型であるツイストルーアーフットポリエチレンボトルは、ボトルを柔らかくし、より内用液を押し出し易くしています。



ボトルサイズ (mm)	径: 23.6 × 21.5
	全長: 99.0
楕円形ボトル	
GS1: (01)04987792952389	




ボトルサイズ (mm)	径: 24.1 × 24.1
	全長: 89.5
真円形ボトル	
GS1: (01)04987792700799	

(裏面に続く)

② 個装箱の仕様変更等

(1) 次の通りデザイン及びサイズを変更致します。

また、個装箱を保管箱として使用できる様に、天面と底面を除く全面にジッパー加工（切り取り線）を追加致します。

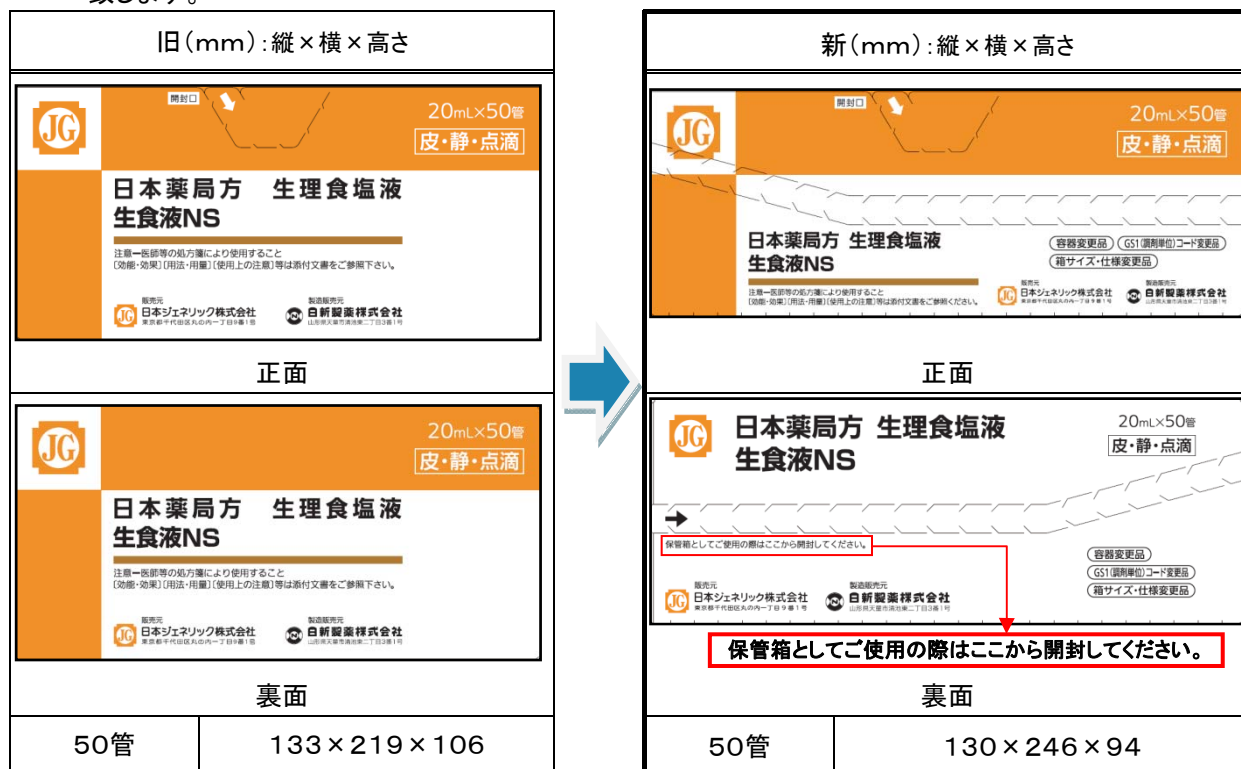

(2) 捺印部の変更: 製造番号等捺印部分を白地から黒地に変更致します。

変更品の出荷時期と初回製造番号

製品名	包装単位	出荷予定時期	初回製造番号	使用期限
生食液NS ツイストルアーポリエチレンボトル	20mL×50管	2018年8月頃	80021A	2021年3月

製品の流通状況により、変更品のお届けまでに多少の時間を要する場合がありますので、ご了承頂きますようお願い致します。
※生食液NSワイドオープンポリエチレンボトル(20mL)及び生食液NSルアーフィットポリエチレンボトル(5mL)につきましては、変更ございません。

変更品の個装箱表示

個装箱に **容器変更品**、**GS1(調剤単位)コード変更品** 及び **箱サイズ・仕様変更品** の表示を致します。

お問い合わせ先

お客さま相談室: 0120-893-170

受付時間: 月～金9:00～18:00(祝日を除く)

以上

包装変更などのお知らせ文書は、弊社の医療関係者向けホームページにも掲載しております。

<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>